

**PROCESSO:** 2019/305550/006624**SGD:** 2021/305559/076652**DE:** Diretoria de Suprimentos Hospitalares**PARA:** Superintendência da Central de Licitação**PARECER TÉCNICO - 258/2021/SES/SAEL/DSH**

Em atenção ao solicitado no despacho nº 672/2021 às fls.1235 e considerando a documentação das empresas licitantes anexadas às fls.946 a 1234, referente ao Pregão nº 008/2021. Segue pronunciamento desta Diretoria:

Considerando que os documentos analisados pela área técnica são: Validade da proposta de 120 dias, atestado de capacidade técnica e Licença de Funcionamento emitida pela vigilância sanitária Distrital, Estadual ou Municipal, informaram que os documentos apresentados pela empresa licitante estão condizentes com o Edital conforme quadro abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	FORNECEDOR	MARCA/FAB.	PARECER DOCUMENTOS	PARECER PRODUTOS	RESULTADO FINAL
01	KIT ANESTESIA COMPLETO: BALAO PARA BARAKA 500 ML EM BORRACHA NATURAL (LATEX) COM CONECTOR COM ENTRADA DE GAS, VALVULA UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO COM VALVULA DE SEGURANCA TUBO TRAQUEIA PARA BARAKA CONFECCIONADO EM SILICONE COM CONECTOR DUPLO TIPO T PARA ENTRADA DE GAS E CONECTOR COTOVELO PARA CONECTAR COM MASCARA CONTENDO BOJO E COXIM EM SILICONE.	ESFERA	PROTEC	FAVORAVEL	DESFAVORAVEL	REPROVADO por falta de amostra.
02	KIT ANESTESIA COMPLETO CONTENDO BALAO PARAANESTESIA BARAKA 1 LITRO EM BORRACHA NATURAL (LATEX) COM CONECTOR COM ENTRADA DE GAS, VALVULA UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO COM VALVULA DE SEGURANCA TUBO TRAQUEIA PARA BARAKA CONFECCIONADO EM SILICONE COM CONECTOR DUPLO TIPO T PARA ENTRADA DE GAS E CONECTOR COTOVELO	ESFERA	PROTEC	FAVORAVEL	DESFAVORAVEL	REPROVADO por falta de amostra.





	PARA CONECTAR COM MASCARA CONTENDO BOJO E COXIM EM SILICONE.					
03	KIT ANESTESIA COMPLETO CONTENDO BALAO PARAANESTESIA BARAKA 2 LITRO EM BORRACHA NATURAL (LATEX) COM CONECTOR COM ENTRADA DE GAS, VALVULA UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO COM VALVULA DE SEGURANCA TUBO TRAQUEIA PARA BARAKA CONFECIONADO EM SILICONE COM CONECTOR DUPLO TIPO T PARA ENTRADA DE GAS E CONECTOR COTOVELO PARA CONECTAR COM MASCARA CONTENDO BOJO E COXIM EM SILICONE	PATRICIA	PROTEC	FAVORAVEL	DESFAVORAVEL	REPROVADO conforme Parecer Técnico Hospitalar anexado as fls. 1256/1264.
04	KIT ANESTESIA COMPLETO CONTENDO BALAO PARA ANESTESIA BARAKA 3 LITROS EM BORRACHA NATURAL (LATEX) COM CONECTOR COM ENTRADA DE GAS, VALVULA UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO COM VALVULA DE SEGURANCA TUBO TRAQUEIA PARA BARAKA CONFECIONADO EM SILICONE COM CONECTOR DUPLO TIPO T PARA ENTRADA DE GAS E CONECTOR COTOVELO PARA CONECTAR COMMASCARA CONTENDO BOJO E COXIM EM SILICONE.	FRACASSADO				FRACASSADO





05	KIT ANESTESIA COMPLETO CONTEUDO BALAO PARAANESTESIA BARAKA 5 LITROS EM BORRACHA NATURAL (LATEX) COM CONECTOR COM ENTRADA DE GAS, VALVULAUNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO COM VALVULA DE SEGURANCA TUBO TRAQUEIA PARA BARAKA CONFECCIONADO EM SILICONE COM CONECTOR DUPL0 TIPO T PARA ENTRADA DE GAS E CONECTOR COTOVELO PARA CONECTAR COM MASCARA CONTEUDO BOJO E COXIM EM SILICONE.	FRACASSADO				FRACASSADO
06	KIT C.P.A.P. NASAL N. 0 (PRONGA) CONFECCIONADA EM SILICONEGRAU CIRURGICO, ESTERIL, MACIO, TRANSPARENTE CONTEUDO 2TUBOS TRAQUEIA CORRUGADOS, CONECTOR DE 22MM, CONECTOR15MM, CONECTOR CANULA / TRAQUEIA, UM TUBO TRAQUEIA CORRUGADO PARA UMIDIFICACAO, CONECTOR COM ENTRADA PARA LINHA DE PRESSAO, LINHA DE MONITORACAO DA PRESSAO, DOIS ADAPTADORES PARA UMIDIFICACAO, UM ADAPTADOR LUER, TOUCA EM MALHA TUBULAR DE ALGODAO SEM COSTURA LATERAL COM FIXADOR EM TECIDO DE POLIAMIDA DUBLADA COM ESPUMA DE POLIURETANO COM FIXADOR EM VELCRO; DOIS BLOCOS DE ESPUMA EM POLIURETANO PARA OPOSICIONAMENTO DAS TRAQUEIAS E/OU LINHA DE PRESSAO. EMBALAGEM INDIVIDUAL	VENTCARE	VENTCARE	FAVORAVEL	DESFAVORAVEL	REPROVADO conforme Parecer Técnico Hospitalar anexado as fls. 1265/1266.





07	KIT CANULA C.P.A.P. NASAL N. 00 (PRONGA) CONFECCIONADA EM SILICONE GRAU CIRURGICO, ESTERIL, MACIO, TRANSPARENTE CONTENDO 2 TUBOS TRAQUEIA CORRUGADOS, CONECTOR DE 22MM, CONECTOR 15MM, CONECTOR CANULA / TRAQUEIA , UM TUBO TRAQUEIA CORRUGADO PARA UMIDIFICACAO, CONECTOR COM ENTRADA PARA LINHA DE PRESSAO, LINHA DE MONITORACAO DA PRESSAO, DOIS ADAPTADORES PARA UMIDIFICACAO, UM ADAPTADOR LUER, TOUCA EM MALHA TUBULAR DE ALGODAO SEM COSTURA LATERAL COM FIXADOR EM TECIDO DE POLIAMIDA DUBLADA COM ESPUMA DE POLIURETANO COM FIXADOR EM VELCRO, DOIS BLOCOS DE ESPUMA EM POLIURETANO PARA O POSICIONAMENTO DAS TRAQUEIAS E/OU LINHA DE PRESSAO. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	VENTCARE	VENTCARE	FAVORAVEL	DESFAVORAVEL	REPROVADO conforme Parecer Técnico Hospitalar anexado as fls. 1265/1266
08	KIT C.P.A.P. NASAL N. 01 (PRONGA) (PRONGA) CONFECCIONADA EM SILICONE GRAU CIRURGICO, ESTERIL, MACIO, TRANSPARENTE CONTENDO 2 TUBOS TRAQUEIA CORRUGADOS, CONECTOR DE 22MM, CONECTOR 15MM, CONECTOR CANULA / TRAQUEIA, UM TUBO TRAQUEIA CORRUGADO PARA UMIDIFICACAO, CONECTOR COM ENTRADA PARA LINHA DE PRESSAO, LINHA DE MONITORACAO DA PRESSAO, DOIS ADAPTADORES PARA UMIDIFICACAO, UM ADAPTADOR LUER, TOUCA EM MALHA TUBULAR DE ALGODAO SEM COSTURA LATERAL COM FIXADOR EM TECIDO DE POLIAMIDA DUBLADA COM ESPUMA DE POLIURETANO COM FIXADOR EM VELCRO, DOIS BLOCOS DE ESPUMA EM POLIURETANO PARA O POSICIONAMENTO DAS TRAQUEIAS E/OU LINHA DE PRESSAO. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	VENTCARE	VENTCARE	FAVORAVEL	DESFAVORAVEL	REPROVADO conforme Parecer Técnico Hospitalar anexado as fls. 1265/1266.





09	KIT C.P.A.P. NASAL N. 02 (PRONGA (PRONGA) CONFECIONADA EM SILICONE GRAU CIRURGICO, ESTERIL, MACIO, TRANSPARENTE CONTENDO 2 TUBOS TRAQUEIA CORRUGADOS, CONECTOR DE 22MM, CONECTOR 15MM, CONECTOR CANULA/TRAQUEIA; UM TUBO TRAQUEIA CORRUGADO PARA UMIDIFICACAO, CONECTOR COM ENTRADA PARA LINHA DE PRESSAO, LINHA DE MONITORACAO DA PRESSAO, DOIS ADAPTADORES PARA UMIDIFICACAO, UM ADAPTADOR LUER, TOUCA EM MALHA TUBULAR DE ALGODAO SEM COSTURA LATERAL COM FIXADOR EM TECIDO DE POLIAMIDA DUBLADA COM ESPUMA DE POLIURETANO COM FIXADOR EM VELCRO, DOIS BLOCOS DE ESPUMA EM POLIURETANO PARA O POSICIONAMENTO DAS TRAQUEIAS E/OU LINHA DE PRESSAO. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	VENTCARE	VENTCARE	FAVORAVEL	DESFAVORAVEL	REPROVADO conforme Parecer Técnico Hospitalar anexado as fls. 1265/1266.
10	CAPACETE OXIGENOTERAPIA NEONATAL, MATERIAL ACRILICO TRANSPARENTE, TAMANHO RN MENOR QUE 1,0 KG, COMPOSICAO CORPO CILINDRICO COM ABERTURA FRONTAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TAMPO SUPERIOR REMOVIVEL, COM ORIFICIO CENTRAL, COMPONENTE ADICIONAL ORIFICIOS LATERAIS	MAXLAB	OLIDEF	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO
11	CAPACETE OXIGENO TERAPIA NEONATAL, MATERIAL ACRILICO TRANSPARENTE, TAMANHO RN DE 1,0 A CERCA DE 3,5 KG, COMPOSICAO CORPO CILINDRICO COM ABERTURA FRONTAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TAMPO SUPERIOR REMOVIVEL, COM ORIFICIO CENTRAL, COMPONENTE ADICIONAL ORIFICIOS LATERAIS	ATIVIDADE	OLIDEF	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO





	ATIVIDADE	OLIDEF	FAVORAVEL	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO
12	CAPACETE OXIGENO TERAPIA NEONATAL, MATERIAL ACRILICO TRANSPARENTE, TAMANHO RN ACIMA DE 3,5 KG, COMPOSICAO CORPO CILINDRICO COM ABERTURA FRONTAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TAMPO SUPERIOR REMOVIVEL, COM ORIFICIO CENTRAL, COMPONENTE ADICIONAL ORIFICIOS LATERAIS.					
13	ASPIRADOR DE REDE VENTURI PARA OXIGENIO COM FRASCO VIDRO500ML SEM MANOMETRO COM TAMPAE BOIA ETIQUETAS E CONEXOES EM CONFORMIDADE COM ABNT NR 11906	HAOXI	FAVORAVEL	FAVORAVEL	DESFAVORAVEL	REPROVADO por falta de amostra.
14	ASPIRADOR DE REDE VENTURI PARA OXIGENIO COM FRASCO VIDRO500ML SEM MANOMETRO COM TAMPAE BOIA ETIQUETAS E CONEXOES EM CONFORMIDADE COM ABNT NR 11906	HAOXI	FAVORAVEL	FAVORAVEL	DESFAVORAVEL	REPROVADO por falta de amostra.
15	ASPIRADOR DE REDE VACUOMETRO COM FRASCO VIDRO CAPACIDADE DE 500ML COM MANOMETRO, TAMPAE BOIA ETIQUETAS E CONEXOES EM CONFORMIDADE COM ABNT NR 11906.	HAOXI	FAVORAVEL	FAVORAVEL	DESFAVORAVEL	REPROVADO por falta de amostra.





16	ASPIRADOR DE REDE VACUOMETRO COM FRASCO VIDRO CAPACIDADE DE 500ML COM MANOMETRO, TAMPAE BOIA ETIQUETAS E CONEXOES EM CONFORMIDADE COM ABNT NR 11906	ESFERA	HAOXI	FAVORAVEL	DESFAVORAVEL	REPROVADO por falta de amostra.
17	ASPIRADOR DE REDE VENTURI PARA AR COMPRIMIDO COM FRASCO VIDRO 500ML SEM MANOMETRO COM TAMPA E BOIA ETIQUETAS E CONEXOES EM CONFORMIDADE COM ABNT NR 11906	ESFERA	HAOXI	FAVORAVEL	DESFAVORAVEL	REPROVADO por falta de amostra.
18	ASPIRADOR DE REDE VENTURI PARA AR COMPRIMIDO COM FRASCO VIDRO 500ML SEM MANOMETRO COM TAMPA E BOIA ETIQUETAS E CONEXOES EM CONFORMIDADE COM ABNT NR 11906	ESFERA	HAOXI	FAVORAVEL	DESFAVORAVEL	REPROVADO por falta de amostra.
19	TUBO TRAQUEIA PARA BARAKA CONFECIONADO EM SILICONE TAMANHO 300MM COM CONECTOR DUPLO TIPO T PARA ENTRADA DE GAS E CONECTOR COTOVELO PARA CONECTAR COM MASCARA	VENTCARE	VENTCARE	FAVORAVEL	DESFAVORAVEL	REPROVADO por falta de amostra.





20	TUBO TRAQUEIA PARA BARAKA CONFECCIONADO EM SILICONE TAMANHO 300MM COM CONECTOR DUPLO TIPO T PARA ENTRADA DE GAS E CONECTOR COTOVELO PARA CONECTAR COM MASCARA	VENTCARE	VENTCARE	FAVORAVEL	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO
21	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO PARA REDE PARA GASES MEDICINAIS AR COMPRIMIDO CONEXOES E ETIQUETAS EM CONFORMIDADE COM ABNT NR 119006.	ESFERA	HAOXI	FAVORAVEL	DESFAVORAVEL	DESFAVORAVEL	REPROVADO por falta de amostra.
22	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO PARA REDE PARA GASES MEDICINAIS OXIGENIO CONEXOES E ETIQUETAS EM CONFORMIDADE COM ABNT NR 119006.	ESFERA	HAOXI	FAVORAVEL	DESFAVORAVEL	DESFAVORAVEL	REPROVADO por falta de amostra.
23	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO PARA REDE PARA GASES MEDICINAIS OXIGENIO CONEXOES E ETIQUETAS EM CONFORMIDADE COM ABNT NR 119006.	ESFERA	HAOXI	FAVORAVEL	DESFAVORAVEL	DESFAVORAVEL	REPROVADO por falta de amostra.





24	VALVULA REGULADORA PRESSAO PARA CILINDRO DE OXIGENIO CONEXOES E ETIQUETAS EM CONFORMIDADE COM ABNT NR119006.	ESFERA	IFAB	FAVORAVEL	DESFAVORAVEL	REPROVADO por falta de amostra.
25	VALVULA REGULADORA PRESSAO PARA CILINDRO DE OXIGENIO CONEXOES E ETIQUETAS EM CONFORMIDADE COM ABNT NR 119006.	ESFERA	IFAB	FAVORAVEL	DESFAVORAVEL	REPROVADO por falta de amostra.
26	MASCARA PARA BARAKA INFLAVEL TAMANHO ADULTO, CONTENDO BOJO E COXIM EM SILICONE.	FRACASSADO				FRACASSADO
27	MASCARA PARA BARAKA INFLAVEL TAMANHO INFANTIL, CONTENDO BOJO E COXIM EM SILICONE.	FRACASSADO				FRACASSADO





28	MASCARA PARA BARAKA INFLAVEL TAMANHO PEDIATRICO CONTENDO BOJO E COXIM EM SILICONE	FRACASSADO	FRACASSADO				FRACASSADO
29	MASCARA DE TRAQUEOSTOMIA TAMANHO ADULTO PARA OXIGENIOTERAPIA EM TRAQUEOSTOMIA OU LARINGECTOMIA, CONFECIONADA EM VINIL MACIO E TRANSPARENTE, MATERIAL ATOXICOE FLEXIVEL, COM FAIXA ELASTICA AJUSTAVEL. CONTEM CUPULA EM ACRILICO TRANSPARENTE PARA VISUALIZACAO, E CONECTOR EM MATERIAL PLASTICO, ATOXICO, QUE PERMITE ANGULO GIRATORIO DE ATE 360° E ENTRADA PARA CIRCUITO MEDIDA PADRAO	FRACASSADO	AUDAX MED	MD/MACROSUL	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO
30	MASCARA DE VENTURI TAMANHO ADULTO COM ELASTICO CONFECIONADA EM PVC COM TRAQUEIA CORRUGADA, ADAPTADOR PARA UMIFICACAO / INALACAO, EXTENSAO PARA CONEXAO NO UMIFICADOR E CATETER, SEIS VALVULAS PARA CONCENTRACAO DE OXIGENIO DIFERENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	FRACASSADO	AUDAX MED	MD/MACROSUL	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO
31	MASCARA DE VENTURI TAMANHO INFANTIL COM ELASTICO CONFECIONADA EM PVC COM TRAQUEIA CORRUGADA, ADAPTADOR PARA UMIFICACAO / INALACAO, EXTENSAO PARA CONEXAO NO UMIFICADOR E CATETER, SEIS VALVULAS PARA CONCENTRACAO DE OXIGENIO DIFERENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL	FRACASSADO	AUDAX MED	MD/MACROSUL	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO





32	MASCARA EM PVC FLEXIVEL PARA OXIGENIO, MEDIA, COM ELASTICO PARA FIXACAO, PRESILHA DE MODELAGEM E MANGUITO, RESISTENTE A ESTERILIZACAO EM 134°C.	FRACASSADO				FRACASSADO
33	MASCARA EM PVC FLEXIVEL PARA OXIGENIO, PEQUENA, COM ELASTICO PARA FIXACAO, PRESILHA DE MODELAGEM E MANGUITO, RESISTENTE A ESTERILIZACAO EM 134°C.	FRACASSADO				FRACASSADO
34	MASCARA FACIAL OXIGENIOTERAPIA NEONATAL N° 0 EM SILICONE, REUTILIZAVEL, AUTOCLAVAVEL A134° PARA USO EM REANIMADOR OU VENTILACAO.	FRACASSADO				FRACASSADO
35	MASCARA FACIAL OXIGENIOTERAPIA NEONATAL N° 00 EM SILICONE, REUTILIZAVEL, AUTOCLAVAVEL A134° PARA USO EM REANIMADOR OU VENTILACAO.	FRACASSADO				FRACASSADO





	ATIVIDADE	FOYOMED	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO
40	MASCARA AEROSOL TAMANHO INFANTIL PARA OXIGENIOTERAPIA, CONFECCIONADA EM VINIL MACIO E TRANSPARENTE QUE PERMITE VISUALIZACAO DO PACIENTE. MATERIAL ATOXICO E FLEXIVEL, COM FAIXA ELASTICA AJUSTAVEL A FACE DO PACIENTE. DEVERA CONTER PRESILHA AJUSTAVEL AO NARIZ ASSEGURANDO BOA FIXACAO. CONEXAO EXTERNA PARA TUBO TAMANHO PADRAO.			FAVORAVEL	APROVADO
41	MASCARA FACIAL TIPO PERFORMAX (FACE TOTAL) TAMANHO GRANDE PARA USO EM VENTILADORES DE UTI, CIRCUITOS DE RAMAL DUPLO OU COM PLATAFORMAS DE VNI DEDICADAS, COM CIRCUITOS DE RAMAL UNICO. COTOVELO AZUL SEM VALVULA DE EXALACAO, PRESILHAS DE PRESSAO, FIXADOR, ALMOFADA DE SILICONE; PERMITE VISAO DESOBSTRUIDA. DESINFECCAO QUIMICA OU TERMICA.				FRACASSADO
42	MASCARA FACIAL TIPO PERFORMAX (FACE TOTAL) TAMANHO PEQUENO PARA USO EM VENTILADORES DE UTI, CIRCUITOS DE RAMAL DUPLO OU COM PLATAFORMAS DE VNI DEDICADAS, COM CIRCUITOS DE RAMAL UNICO. COTOVELO AZUL SEM VALVULA DE EXALACAO, PRESILHAS DE PRESSAO, FIXADOR, ALMOFADA DE SILICONE, PERMITE VISAO DESOBSTRUIDA. DESINFECCAO QUIMICA OU TERMICA.				FRACASSADO
43	MASCARA LARINGEA Nº 1 CONFECCIONADA EM SILICONE GRAU MEDICO, ISENTA DE LATEX, RESISTENTE A TORCAO E DOBRAS, AUSENCIA DE TRABECULAS, LINHA PARA REFERENCIA DE POSICAO, REUTILIZAVEL, AUTOCLAVAVEL NO MINIMO POR 40 VEZES. EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA			FAVORAVEL	APROVADO Conforme Parecer Técnico hospitalar anexado as fls. 12366/1264.





44	MASCARA LARINGEA Nº. 1,5 CONFECCIONADA EM SILICONE GRAU MEDICO, ISENTA DE LATEX, RESISTENTE A TORCAO E DOBRAS, AUSENCIA DE TRABECULAS, LINHA PARA REFERENCIA DE POSICAO, REUTILIZAVEL, AUTOCLAVAVEL NO MINIMO POR 40 VEZES. EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA.	ATIVIDADE	MD	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO Conforme Parecer Técnico hospitalar anexado as fls. 1236/1264.
45	MASCARA LARINGEA Nº. 2 CONFECCIONADA EM SILICONE GRAU MEDICO, ISENTA DE LATEX, RESISTENTE A TORCAO E DOBRAS, AUSENCIA DE TRABECULAS, LINHA PARA REFERENCIA DE POSICAO, REUTILIZAVEL, AUTOCLAVAVEL NO MINIMO POR 40 VEZES. EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA	ATIVIDADE	MD	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO Conforme Parecer Técnico hospitalar anexado as fls. 1236/1264.
46	MASCARA LARINGEA Nº. 2,5 CONFECCIONADA EM SILICONE GRAU MEDICO, ISENTA DE LATEX, RESISTENTE A TORCAO E DOBRAS, AUSENCIA DE TRABECULAS, LINHA PARA REFERENCIA DE POSICAO, REUTILIZAVEL, AUTOCLAVAVEL NO MINIMO POR 40 VEZES. EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA.	ATIVIDADE	MD	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO Conforme Parecer Técnico hospitalar anexado as fls. 1236/1264.
47	MASCARA LARINGEA Nº. 3 CONFECCIONADA EM SILICONE GRAU MEDICO, ISENTA DE LATEX, RESISTENTE A TORCAO E DOBRAS, AUSENCIA DE TRABECULAS, LINHA PARA REFERENCIA DE POSICAO, REUTILIZAVEL, AUTOCLAVAVEL NO MINIMO POR 40 VEZES. EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA.	ATIVIDADE	MD	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO Conforme Parecer Técnico hospitalar anexado as fls. 1236/1264.





SECRETARIA
DA SAÚDE

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO

Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias, S/N
Palmas – Tocantins – CEP: 77.015-007
Tel.: +55 63 3218-1700
saude.to.gov.br

48	MASCARA LARINGEA Nº. 4 CONFECCIONADA EM SILICONE GRAU MEDICO, ISENTA DE LATEX, RESISTENTE A TORCAO E DOBRAS, AUSENCIA DE TRABECULAS, LINHA PARA REFERENCIA DE POSICAO, REUTILIZAVEL, AUTOCLAVAVEL NO MINIMO POR 40 VEZES. EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA.	ATIVIDADE	MD	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO Conforme Parecer Técnico hospitalar anexado as fls. 1236/1264.
49	MASCARA LARINGEA Nº. 5 CONFECCIONADA EM SILICONE GRAU MEDICO, ISENTA DE LATEX, RESISTENTE A TORCAO E DOBRAS, AUSENCIA DE TRABECULAS, LINHA PARA REFERENCIA DE POSICAO REUTILIZAVEL, AUTOCLAVAVEL NO MINIMO POR 40 VEZES. EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA.	ATIVIDADE	MD	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO Conforme Parecer Técnico hospitalar anexado as fls. 1236/1264.
50	MASCARA NASAL PARA VNI, PEQUENA, COM SUPORTE PARA PRESILHA E SUPORTE PARA TESTA, CAMADA EXTERNA EM SILICONE E CAMADA INTERNA EM GEL REMOVIVEL. ACAMPAHA PRESILHA COM QUATRO PONTOS DE FIXACAO. RESISTENTE A ESTERILIZACAO EM 134 °C.	FRACASSADO				FRACASSADO
51	MASCARA ORONASAL PARA VNI, GRANDE, COM SUPORTE PARA PRESILHA E SUPORTE PARA TESTA, CAMADA EXTERNA EM SILICONE E CAMADA INTERNA EM GEL REMOVIVEL. ACAMPAHA PRESILHA COM QUATRO PONTOS DE FIXACAO. RESISTENTE A ESTERILIZACAO EM 134 °C.	FRACASSADO				FRACASSADO





52	MASCARA ORONASAL PARA VNI, MEDIA, COM SUPORTE PARA PRESILHA E SUPORTE PARA TESTA, CAMADA EXTERNA EM SILICONE E CAMADA INTERNA EM GEL REMOVIVEL. ACAMPAHA PRESILHA COM QUATRO PONTOS DE FIXACAO. RESISTENTE A ESTERILIZACAO EM 134 °C	FRACASSADO				FRACASSADO
53	MASCARA ORONASAL PARA VNI, PEQUENA, COM SUPORTE PARA PRESILHA E SUPORTE PARA TESTA, CAMADA EXTERNA EM SILICONE E CAMADA INTERNA EM GEL REMOVIVEL. ACAMPAHA PRESILHA COM QUATRO PONTOS DE FIXACAO. RESISTENTE A ESTERILIZACAO EM 134 °C.	FRACASSADO				FRACASSADO
54	MASCARA DE PROTECAO FACIAL TIPO RESPIRADOR, APLICACAO: PROTECAO CONTRA BACILO DA TUBERCULOSE, CONSTITUIDO POR FIBRAS SINTETICAS DISPOSTAS EM 4 CAMADAS COM FORMADOS EM CONCHA OU BICO DE PATO; DUAS TIRAS ELASTICAS PARA FIXACAO NA CABECA, CLIPE NASAL FIXADO NO CORPO DA MASCARA E EFICIENCIA MINIMA DE FILTRACAO DE 95% DE PARTICULAS DE ATE0,3 MICROMETROS. COM CERTIFICADO DE APROVACAO COMO PFF/2 E DA NIOSHI COMO N95 E REGISTRO DO MS. DESCARTAVEL. ATOXICA E HIPOALERGENICA. INODORA.	AUDAX MED	ALLIANCE	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO Conforme Parecer Técnico hospitalar anexado as fls. 1267/1276.





55	MASCARA DE PROTECAO FACIAL TIPO RESPIRADOR, APLICACAO: PROTECAO CONTRA BACILO DA TUBERCULOSE, CONSTITUIDO POR FIBRAS SINTETICAS DISPOSTAS EM 4CAMADAS COM FORMADOS EM CONCHA OU BICO DE PATO; DUAS TIRAS ELASTICAS PARA FIXACAO NA CABECA, CLIPE NASAL FIXADO NO CORPO DA MASCARA E EFICIENCIA MINIMA DE FILTRACAO DE 95% DE PARTICULAS DE ATE0,3 MICROMETROS. COM CERTIFICADO DE APROVACAO COMO PFF/2 E DA NIOSH COMO N95 E REGISTRO DO MS. DESCARTAVEL. ATOXICA E HIPOALERGENICA. INODORA.	AUDAX MED	ALLIANCE	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO Conforme Parecer Técnico hospitalar anexado as fls. 1267/1276.
----	--	-----------	----------	-----------	-----------	---

Explicitamos que as fls 1236/1255 seguem o Ofício de solicitação de amostra para os fornecedores vencedores. Em atenção aos autos explicitamos que é de extrema necessidade da **Homologação Parcial de caráter de urgência do PE: 008/2021** tendo em vista, que as Unidades Hospitalares encontram-se desabastecidas, informamos ainda, que a falta destes compromete diretamente os profissionais e pacientes internados nas Unidades, tendo em vista que estes materiais “OXIGENIOTERAPIA” são imprescindíveis no atendimento hospitalar.

Palmas, 25/05/2021.

Assinatura Digital
Afrânia Nogueira de Souza
Mat. 11706554/1

Assinatura Digital
Gileno Dias de Oliveira
Diretor de Suprimentos Hospitalares



**SOLICITAÇÃO - 70/2021/SES/SAEL/DSH**
SGD: 2021/30559/060853**PROCESSO Nº.** 2019/30550/006624**INTERESSADO:** Diretoria de Suprimentos Hospitalares**PARA:** Equipe Técnica do HGP- Hospital Geral Público de Palmas**ASSUNTO:** Análise e Parecer Técnico

Prezado Senhor Diretor,


Considerando a relevante importância em suprir as demandas das unidades hospitalares do Estado de Tocantins, com materiais adequados, essa Diretoria de Suprimentos Hospitalares, remete ao Hospital supracitado, análise e parecer técnico dos insumos, caso haja necessidade de amostras para realizar a análise, favor informar e solicitar em tempo hábil de 02 (dois) dias úteis, após o recebimento deste.

Considerando que as unidades hospitalares estão desabastecidas com vários destes itens, solicitamos ainda urgência na análise e respostas. Ressaltamos ainda que o mesmo está em fase de finalização do processo licitatório, informo o Pregão eletrônico nº 008/2021.

Segue itens abaixo:


ITEM	UND	FAB/MARCA	PARECER
03		PROTEC	
10/20		VENTCARE	





29	MASCARA DE TRAQUEOSTOMIA TAMANHO ADULTO PARA OXIGENIOTERAPIA EM TRAQUEOSTOMIA OU LARINGECTOMIA, CONFECCIONADA EM VINIL MACIO E TRANSPARENTE, MATERIAL ATOXICO E FLEXIVEL, COM FAIXA ELASTICA AJUSTAVEL CONTEM CUPULA EM ACRILICO TRANSPARENTE PARA VISUALIZACAO, E CONECTOR EM MATERIAL PLASTICO, ATOXICO, QUE PERMITE ANGULO GIRATORIO DE ATE 360° E ENTRADA PARA CIRCUITO MEDIDA PADRAO		MD/ MACROSUL	
30	MASCARA DE VENTURI TAMANHO ADULTO COM ELASTICO CONFECCIONADA EM PVC COM TRAQUEIA CORRUGADA, ADAPTADOR PARA UMIDIFICACAO / INALACAO, EXTENSAO PARA CONEXAO NO UMIDIFICADOR E CATETER, SEIS VALVULAS PARA CONCENTRACAO DE OXIGENIO DIFERENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL.		MD/ MACROSUL	
31	MASCARA DE VENTURI TAMANHO INFANTIL COM ELASTICO CONFECCIONADA EM PVC COM TRAQUEIA CORRUGADA, ADAPTADOR PARA UMIDIFICACAO / INALACAO, EXTENSAO PARA CONEXAO NO UMIDIFICADOR E CATETER, SEIS VALVULAS PARA CONCENTRACAO DE OXIGENIO DIFERENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL.		MD/ MACROSUL	
43	MASCARA LARINGEA Nº 1 CONFECCIONADA EM SILICONE GRAU MEDICO, ISENTA DE LATEX, RESISTENTE A TORCAO E DOBRAS, AUSENCIA DE TRABECULAS, LINHA PARA REFERENCIA DE POSICAO, REUTILIZAVEL, AUTOCLAVAVEL NO MINIMO POR 40 VEZES. EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA		MD	
44	MASCARA LARINGEA Nº. 1,5 CONFECCIONADA EM SILICONE GRAU MEDICO, ISENTA DE LATEX, RESISTENTE A TORCAO E DOBRAS, AUSENCIA DE TRABECULAS, LINHA PARA REFERENCIA DE POSICAO, REUTILIZAVEL, AUTOCLAVAVEL NO MINIMO POR 40 VEZES. EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA.		MD	
45	MASCARA LARINGEA Nº. 2 CONFECCIONADA EM SILICONE GRAU MEDICO, ISENTA DE LATEX, RESISTENTE A TORCAO E DOBRAS, AUSENCIA DE TRABECULAS, LINHA PARA REFERENCIA DE POSICAO, REUTILIZAVEL, AUTOCLAVAVEL NO MINIMO POR 40 VEZES. EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA		MD	
46	MASCARA LARINGEA Nº. 2,5 CONFECCIONADA EM SILICONE GRAU MEDICO, ISENTA DE LATEX, RESISTENTE A TORCAO E DOBRAS, AUSENCIA DE TRABECULAS, LINHA PARA REFERENCIA DE POSICAO, REUTILIZAVEL, AUTOCLAVAVEL NO MINIMO POR 40 VEZES. EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA.		MD	





47	MASCARA LARINGEA Nº. 3 CONFECCIONADA EM SILICONE GRAU MEDICO, ISENTA DE LATEX, RESISTENTE A TORCAO E DOBRAS, AUSENCIA DE TRABECULAS, LINHA PARA REFERENCIA DE POSICAO, REUTILIZAVEL, AUTOCLAVAVEL NOMINIMO POR 40 VEZES. EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA.		MD	
48	MASCARA LARINGEA Nº. 4 CONFECCIONADA EM SILICONE GRAU MEDICO, ISENTA DE LATEX, RESISTENTE A TORCAO E DOBRAS, AUSENCIA DE TRABECULAS, LINHA PARA REFERENCIA DE POSICAO, REUTILIZAVEL, AUTOCLAVAVEL NO MINIMO POR 40 VEZES. EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA.		MD	
49	MASCARA LARINGEA Nº. 5 CONFECCIONADA EM SILICONE GRAU MEDICO, ISENTA DE LATEX, RESISTENTE A TORCAO E DOBRAS, AUSENCIA DE TRABECULAS, LINHA PARA REFERENCIA DE POSICAO REUTILIZAVEL, AUTOCLAVAVEL NOMINIMO POR 40 VEZES. EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA.		MD	

Atenciosamente,

Palmas, 29/04/2021.

Assinatura Digital
Afrânia Nogueira de Souza
Mat. 11706554/1

Assinatura Digital
Gileno Dias de Oliveira
Diretor de Suprimentos Hospitalares






PROCESSO : 2019/30550/006624
INTERESSADO : Diretoria de Suprimentos Hospitalares
ASSUNTO : Parecer de itens do Pregão Eletrônico n°. 008/2021
SGD 2021/30559/071098

PARECER TÉCNICO 47/2021/SES/HGPP/DG

Em resposta à solicitação 70/2021/SES/SAEL/DSH, SGD 2021/30559/060853, levando-se em conta a necessidade do **Hospital Geral Público de Palmas**, segue avaliação do(s) produto(s) ofertado(s) na(s) proposta(s) classificada no Pregão Eletrônico n°. 008/2021, Processo n°. 006624/2019.

PREGÃO ELETRÔNICO N°. 008/2021			
ITEM	DESCRIÇÃO	FAB./ MARCA	RESULTADO
03	KIT ANESTESIA COMPLETO CONTENDO BALÃO PARA ANESTESIA BARAKA (...) CONFORME DESCRITIVO EDITALÍCIO.	PROTEC	REPROVADO Material do balão frágil não possuindo consistência que resista ao processo de esterilização, tomando-o inviável. O conector não se adequa aos aparelhos do HGP. O produto enviado para análise apresentou balão de tamanho de 3 litros. Por tais razões, o produto não supre as necessidades da unidade, com base no item 5, subitem 5.4.1 e 5.4.2, do Anexo II do Edital.
19	TUBO TRAQUEIA PARA BARAKA (...)	VENTCARE	APROVADO
20	CONFORME DESCRITIVO EDITALÍCIO.		






29	MASCARA DE TRAQUEOSTOMIA TAMANHO ADULTO PARA OXIGENIOTERAPIA (...) CONFORME DESCRITIVO EDITALÍCIO.	MD/ MACROSUL	APROVADO
30	MASCARA DE VENTURI TAMANHO ADULTO COM ELÁSTICO (...) CONFORME DESCRITIVO EDITALÍCIO.		
31	MASCARA DE VENTURI TAMANHO INFANTIL COM ELÁSTICO (...) CONFORME DESCRITIVO EDITALÍCIO.		
43	MASCARA LARÍNGEA Nº 1 CONFECCIONADA EM SILICONE (...) CONFORME DESCRITIVO EDITALÍCIO.	MD	APROVADO
44	MASCARA LARÍNGEA Nº 1,5 CONFECCIONADA EM SILICONE (...) CONFORME DESCRITIVO EDITALÍCIO.		
45	MASCARA LARÍNGEA Nº 2 CONFECCIONADA EM SILICONE (...) CONFORME DESCRITIVO EDITALÍCIO.		
46	MASCARA LARÍNGEA Nº 2,5 CONFECCIONADA EM SILICONE (...) CONFORME DESCRITIVO EDITALÍCIO.	MD	APROVADO
47	MASCARA LARÍNGEA Nº 3 CONFECCIONADA EM SILICONE (...) CONFORME DESCRITIVO EDITALÍCIO.		
48	MASCARA LARÍNGEA Nº 4 CONFECCIONADA EM SILICONE (...) CONFORME DESCRITIVO EDITALÍCIO.	MD	APROVADO
49	MASCARA LARÍNGEA Nº 5 CONFECCIONADA EM SILICONE (...) CONFORME DESCRITIVO EDITALÍCIO.		

Palmas, 13 de maio de 2021.

Assinatura Eletrônica
JOÃO CARLOS DIAS MEDEIROS
 Diretor Administrativo e Financeiro

Assinatura Eletrônica
LEONARDO DE O. TOLEDO SILVA
 Diretor Geral



SOLICITAÇÃO - 70/2021/SES/SAEL/DSH
SGD: 2021/30559/060853

PROCESSO Nº. 2019/30550/006624
INTERESSADO: Diretoria de Suprimentos Hospitalares
PARA: Equipe Técnica do HGP- Hospital Geral Público de Palmas
ASSUNTO: Análise e Parecer Técnico

Prezado Senhor Diretor,

Considerando a relevante importância em suprir as demandas das unidades hospitalares do Estado de Tocantins, com materiais adequados, essa Diretoria de Suprimentos Hospitalares, remete ao Hospital supracitado, análise e parecer técnico dos insumos, caso haja necessidade de amostras para realizar a análise, favor informar e solicitar em tempo hábil de 02 (dois) dias úteis, após o recebimento deste.

Considerando que as unidades hospitalares estão desabastecidas com vários destes itens, solicitamos ainda urgência na análise e respostas. Ressaltamos ainda que o mesmo está em fase de finalização do processo licitatório, informo o Pregão eletrônico nº 008/2021.

Segue itens abaixo:

ITEM	UND	FAB/MARCA	PARECER
03 →		PROTEC	Aprovado Bebês deve na de relação e Tomar Diego Alves Garvato 06/04/2021
19/20 →		VENTCARE	Aprovado Diego Alves Garvato 06/04/2021






SESAU
 Proc. _____
 Fl. nº 1262
 AV
 Vista

20	MASCARA DE TRAQUEOSTOMIA TAMANHO ADULTO PARA OXIGENOTERAPIA EM TRAQUEOSTOMIA OU LARINGECTOMIA, CONFECCIONADA EM VINIL MACIO E TRANSPARENTE, MATERIAL ATOXICO E FLEXIVEL, COM FAIXA ELASTICA AJUSTAVEL, CONTEM CUPULA EM ACRILICO, TRANSPARENTE PARA VISUALIZACAO E CONECTOR EM MATERIAL PLASTICO ATOXICO, QUE PERMITE ANGULO OBTUSO DE ATÉ 90º E ENTRADA PARA CIRCUITO MEDIDA PADRAO	MD MACRODUS	<p><i>Dr. Cirlei Bezerra da Silva</i> Coordenadora Fisioterapia HGP CREDITO 12 - 83435.F MATRICULA - 374560-1 83435F</p>
30	MASCARA DE VENTURI TAMANHO ADULTO COM ELASTICO CONFECCIONADA EM PVC COM TRAQUEIA CORRUGADA, ADAPTADOR PARA UMIDIFICACAO FINALICAO, EXTENSOR PARA CONEXAO NO UMIDIFICADOR E CATETER, SEIS VALVULAS PARA CONCENTRACAO DE OXIGENIO DIFERENTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL	MD MACRODUS	<p><i>Dr. Cirlei Bezerra da Silva</i> Coordenadora Fisioterapia HGP CREDITO 12 - 83435.F MATRICULA - 374560-1 83435F</p>
31	MASCARA DE VENTURI TAMANHO INFANTIL COM ELASTICO CONFECCIONADA EM PVC COM TRAQUEIA CORRUGADA, ADAPTADOR PARA UMIDIFICACAO FINALICAO, EXTENSOR PARA CONEXAO NO UMIDIFICADOR E CATETER, SEIS VALVULAS PARA CONCENTRACAO DE OXIGENIO DIFERENTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL	MD MACRODUS	<p><i>Dr. Cirlei Bezerra da Silva</i> Coordenadora Fisioterapia HGP CREDITO 12 - 83435.F MATRICULA - 374560-1 83435F</p>
43	MASCARA LARINGEA Nº 1 CONFECCIONADA EM SILICONE GRAU MEDICO, ISENTA DE LATEX, RESISTENTE A TORCAO E DOBRAS, AUSENCIA DE TRABECULAS, LINHA PARA REFERENCIA DE POSICAO, REUTILIZAVEL, AUTOCLAVAVEL NO MINIMO POR 40 VEZES, EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA	MD	
44	MASCARA LARINGEA Nº 1,5 CONFECCIONADA EM SILICONE GRAU MEDICO, ISENTA DE LATEX, RESISTENTE A TORCAO E DOBRAS, AUSENCIA DE TRABECULAS, LINHA PARA REFERENCIA DE POSICAO, REUTILIZAVEL, AUTOCLAVAVEL NO MINIMO POR 40 VEZES, EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA	MD	
45	MASCARA LARINGEA Nº 2 CONFECCIONADA EM SILICONE GRAU MEDICO, ISENTA DE LATEX, RESISTENTE A TORCAO E DOBRAS, AUSENCIA DE TRABECULAS, LINHA PARA REFERENCIA DE POSICAO, REUTILIZAVEL, AUTOCLAVAVEL NO MINIMO POR 40 VEZES, EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA	MD	
46	MASCARA LARINGEA Nº 2,5 CONFECCIONADA EM SILICONE GRAU MEDICO, ISENTA DE LATEX, RESISTENTE A TORCAO E DOBRAS, AUSENCIA DE TRABECULAS, LINHA PARA REFERENCIA DE POSICAO, REUTILIZAVEL, AUTOCLAVAVEL NO MINIMO POR 40 VEZES, EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA	MD	



SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE TOCANTINS
 Avenida dos Girassóis, Esplanada das Secretarias, S/N - Palmas - TO/77.015-007
 Telefone: (62) 3218-1700 - Fax: (62) 3218-1701 - E-mail: saude@tocantins.gov.br



29	MASCARA DE TRAQUEOSTOMIA TAMANHO ADULTO PARA OXIGENIOTERAPIA EM TRAQUEOSTOMIA OU LARINGECTOMIA, CONFECCIONADA EM VINIL MACIO E TRANSPARENTE. MATERIAL ATOXICO E FLEXIVEL. COM FAIXA ELASTICA AJUSTAVEL. CONTEM CUPULA EM ACRILICO TRANSPARENTE PARA VISUALIZACAO. E CONECTOR EM MATERIAL PLASTICO. ATOXICO. QUE PERMITE ANGULO GIRATORIO DE ATE 360° E ENTRADA PARA CIRCUITO MEDIDA PADRAO		MD/ MACROSUL	
30	MASCARA DE VENTURI TAMANHO ADULTO COM ELASTICO CONFECCIONADA EM PVC COM TRAQUEIA CORRUGADA, ADAPTADOR PARA UMIDIFICACAO /INALACAO, EXTENSAO PARA CONEXAO NO UMIDIFICADOR E CATETER, SEIS VALVULAS PARA CONCENTRACAO DE OXIGENIO DIFERENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL.		MD/ MACROSUL	
31	MASCARA DE VENTURI TAMANHO INFANTIL COM ELASTICO CONFECCIONADA EM PVC COM TRAQUEIA CORRUGADA, ADAPTADOR PARA UMIDIFICACAO /INALACAO, EXTENSAO PARA CONEXAO NO UMIDIFICADOR E CATETER, SEIS VALVULAS PARA CONCENTRACAO DE OXIGENIO DIFERENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL.		MD/ MACROSUL	
43	MASCARA LARINGEA Nº 1 CONFECCIONADA EM SILICONE GRAU MEDICO, ISENTA DE LATEX, RESISTENTE A TORCAO E DOBRAS, AUSENCIA DE TRABECULAS. LINHA PARA REFERENCIA DE POSICAO. REUTILIZAVEL. AUTOCLAVAVEL NO MINIMO POR 40 VEZES. EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA		MD	Aprovado Diego Alves Galvao 05/10/2020
44	MASCARA LARINGEA Nº 1,5 CONFECCIONADA EM SILICONE GRAU MEDICO, ISENTA DE LATEX, RESISTENTE A TORCAO E DOBRAS, AUSENCIA DE TRABECULAS, LINHA PARA REFERENCIA DE POSICAO. REUTILIZAVEL. AUTOCLAVAVEL NO MINIMO POR 40 VEZES. EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA.		MD	Aprovado Diego Alves Galvao 05/10/2020
45	MASCARA LARINGEA Nº 2 CONFECCIONADA EM SILICONE GRAU MEDICO, ISENTA DE LATEX, RESISTENTE A TORCAO E DOBRAS, AUSENCIA DE TRABECULAS, LINHA PARA REFERENCIA DE POSICAO. REUTILIZAVEL. AUTOCLAVAVEL NO MINIMO POR 40 VEZES. EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA		MD	Aprovado Diego Alves Galvao 05/10/2020
46	MASCARA LARINGEA Nº 2,5 CONFECCIONADA EM SILICONE GRAU MEDICO, ISENTA DE LATEX, RESISTENTE A TORCAO E DOBRAS, AUSENCIA DE TRABECULAS, LINHA PARA REFERENCIA DE POSICAO. REUTILIZAVEL. AUTOCLAVAVEL NO MINIMO POR 40 VEZES. EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA		MD	Aprovado Diego Alves Galvao 05/10/2020





47	MASCARA LARINGEA Nº 3 CONFECCIONADA EM SILICONE GRAU MEDICO, ISENTA DE LATEX, RESISTENTE A TORCAO E DOBRAS, AUSENCIA DE TRABECULAS, LINHA PARA REFERENCIA DE POSICAO, REUTILIZAVEL, AUTOCLAVAVEL NOMINIMO POR 40 VEZES, EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA.		MD	Approved GILENO DIAS DE OLIVEIRA 29/04/2021	MV Visto
48	MASCARA LARINGEA Nº 4 CONFECCIONADA EM SILICONE GRAU MEDICO, ISENTA DE LATEX, RESISTENTE A TORCAO E DOBRAS, AUSENCIA DE TRABECULAS, LINHA PARA REFERENCIA DE POSICAO, REUTILIZAVEL, AUTOCLAVAVEL NO MINIMO POR 40 VEZES, EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA.		MD	Approved GILENO DIAS DE OLIVEIRA 29/04/2021	
49	MASCARA LARINGEA Nº 5 CONFECCIONADA EM SILICONE GRAU MEDICO, ISENTA DE LATEX, RESISTENTE A TORCAO E DOBRAS, AUSENCIA DE TRABECULAS, LINHA PARA REFERENCIA DE POSICAO REUTILIZAVEL, AUTOCLAVAVEL NOMINIMO POR 40 VEZES, EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA.		MD	Approved GILENO DIAS DE OLIVEIRA 29/04/2021	

Atenciosamente,

Palmas, 29/04/2021.

Assinatura Digital
Afrânia Nogueira de Souza
Mat. 11706554/1

Assinatura Digital
Gileno Dias de Oliveira
Diretor de Suprimentos Hospitalares





SGD: 2021/30559/059489

PROCESSO Nº: 2019/30550/006624

INTERESSADO: DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES

DE: HOSPITAL E MATERIDADE DONA REGINA

PARA: DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES

ASSUNTO: ANÁLISE E PARECER TÉCNICO

DESPACHO - 6/2021/HRDR/LOG

Em resposta ao **SGD nº 63/2021/SES/SAEL/DSH** a qual solicita Análise e Parecer Técnico sobre os itens 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12 do processo nº 2019/30550/006624, encaminhamos em anexo Parecer da área técnica desta Unidade.

Palmas, 27 de abril de 2021.

Assinatura Eletrônica

FERNANDO PINHEIRO DE MELO
Diretor Administrativo e Financeiro - HMDR



Documento foi assinado digitalmente por FERNANDO PINHEIRO DE MELO em 27/04/2021 17:37:16.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://sgd.to.gov.br/verificador>, informando o código verificador: 60C5111C00C95F7A



Para: Diretoria de Suprimentos Hospitalares
Processo nº 2019/30550/006624


Assunto: PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL SOBRE KIT CPAP NASAL

Informo que os itens 6, 7, 8 e 9 são kits cpap nasal com prongas nº 00, nº D, nº 01, nº 02 que são de péssima qualidade, dobra fácil, colapsa, com prongas muito retificadas, não anatômicas que causam lesão em septo nasal dos recém-nascidos, com necessidade de várias trocas, saindo fácil das narinas necessitando ajustes com placas de hidrocolóide.

Palmas, 26 de abril de 2021

Dra. Milena Cayres
Pediatria
CRM TO 2700/RQE 1556

Milena Cayres
Pediatria
CRM TO 2700/RQE 1556



**SOLICITAÇÃO - 32/2021/SES/SAEL/DSH**
SGD: 2021/30559/051363

PROCESSO Nº. 2019/30550/006624
INTERESSADO: Diretoria de Suprimentos Hospitalares
PARA: Equipe Técnica do HGP- Hospital Geral Público de Palmas.
ASSUNTO: Análise e Parecer Técnico

Prezado Senhor Diretor,

Considerando a relevante importância em suprir as demandas das unidades hospitalares do Estado de Tocantins, com materiais adequados, essa Diretoria de Suprimentos Hospitalares, remete ao Hospital supracitado, análise e parecer técnico dos insumos, caso haja necessidade de amostras para realizar a análise, favor informar e solicitar em tempo hábil de 02 (dois) dias úteis, após o recebimento deste.

Considerando que as unidades hospitalares estão desabastecidas com vários destes itens, solicitamos ainda urgência na análise e respostas. Ressaltamos ainda que o mesmo está em fase de finalização do processo licitatório, informo o Pregão eletrônico nº 008//2020.

Segue itens abaixo:

ITEM	UND	FAB/MARCA	PARECER
54/55		ALLIANCE	
MASCARA DE PROTECAO FACIAL TIPO RESPIRADOR, APLICACAO: PROTECAO CONTRA BACILO DA TUBERCULOSE, CONSTITUIDO POR FIBRAS SINTETICAS DISPOSTAS EM 4 CAMADAS COM FORMADOS EM CONCHA OU BICO DE PATO; DUAS TIRAS ELASTICAS PARA FIXACAO NA CABECA, CLIPE NASAL FIXADO NO CORPO DA MASCARA E EFICIENCIA MINIMA DE FILTRACAO DE 95% DE PARTICULAS DE ATE0,3 MICROMETROS. COM CERTIFICADO DE APROVACAO COMO PFF/2 E DA NIOSH COMO N95 E REGISTRO DO MS. DESCARTAVEL. ATOXICA EHIPOALERGENICA. INODORA.			


Atenciosamente,

Palmas, 09/04/2021.

Assinatura Digital
Afrânia Nogueira de Souza
Mat: 11706554/1

Assinatura Digital
Dayana Gomes da S Martins
Assessor



**SOLICITAÇÃO - 33/2021/SES/SAEL/DSH**
SGD: 2021/30559/051479**PROCESSO Nº.** 2019/30550/006624**INTERESSADO:** Diretoria de Suprimentos Hospitalares**PARA:** Diretoria de regulação, monitoramento e avaliação do trabalho na saúde.**ASSUNTO:** Análise e Parecer Técnico

Prezado Senhor Diretor,

Considerando a relevante importância em suprir as demandas das unidades hospitalares do Estado de Tocantins, com materiais adequados, essa Diretoria de Suprimentos Hospitalares, remete ao Hospital supracitado, análise e parecer técnico dos insumos, caso haja necessidade de amostras para realizar a análise, favor informar e solicitar em tempo hábil de 02 (dois) dias úteis, após o recebimento deste.

Considerando que as unidades hospitalares estão desabastecidas com vários destes itens, solicitamos ainda urgência na análise e respostas. Ressaltamos ainda que o mesmo está em fase de finalização do processo licitatório, informo o Pregão eletrônico nº 008//2020.

Segue itens abaixo:

ITEM	UND	FAB/MARCA	PARECER
54/55		ALLIANCE	
MASCARA DE PROTECAO FACIAL TIPO RESPIRADOR, APLICACAO: PROTECAO CONTRA BACILO DA TUBERCULOSE, CONSTITUIDO POR FIBRAS SINTETICAS DISPOSTAS EM 4 CAMADAS COM FORMADOS EM CONCHA OU BICO DE PATO; DUAS TIRAS ELASTICAS PARA FIXACAO NA CABECA, CLIPE NASAL FIXADO NO CORPO DA MASCARA E EFICIENCIA MINIMA DE FILTRACAO DE 95% DE PARTICULAS DE ATE0,3 MICROMETROS. COM CERTIFICADO DE APROVACAO COMO PFF/2 E DA NIOSH COMO N95 E REGISTRO DO MS. DESCARTAVEL. ATOXICA EHIPOALERGENICA. INODORA.			

Atenciosamente,

Palmas, 12/04/2021.

Assinatura Digital
Afrânia Nogueira de Souza
Mat: 11706554/1

Assinatura Digital
Dayana Gomes da S Martins
Assessor





PROCESSO : 2019/30550/006624
INTERESSADO : Diretoria de Suprimentos Hospitalares
ASSUNTO : Parecer de itens do Pregão Eletrônico n°. 008/2021
SGD 2021/30559/053921

PARECER TÉCNICO 32/2021/SES/HGPP/DG

Em resposta à solicitação 32/2021/SES/SAEL/DSH, SGD 2021/30559/051363, levando-se em conta a necessidade do **Hospital Geral Público de Palmas**, segue avaliação do(s) produto(s) ofertado(s) na(s) proposta(s) classificada(s) no Pregão Eletrônico n°. 008/2021, Processo n°. 2019/30550/006624.

Pregão Eletrônico n°. 008/2021			
ITEM	DESCRIÇÃO	FAB./ MARCA	RESULTADO
54	MASCARA DE PROTECAO FACIAL TIPO RESPIRADOR, APLICACAO: PROTECAO CONTRA BACILO DA TUBERCULOSE, CONSTITUIDO POR FIBRAS SINTETICAS DISPOSTAS EM 4 CAMADAS COM FORMADOS EM CONCHA OU BICO DE PATO; DUAS TIRAS ELASTICAS PARA FIXACAO NA CABECA, CLIPE NASAL FIXADO NO CORPO DA MASCARA E EFICIENCIA MINIMA DE FILTRACAO DE 95% DE PARTICULAS DE ATE0,3 MICROMETROS. COM CERTIFICADO DE APROVACAO COMO PFF/2 E DA NIOSHI COMO N95 E REGISTRO DO MS. DESCARTAVEL. ATOXICA E HIPOALERGENICA. INODORA.	ALLIANCE	APROVADO
55			

Palmas, 14 de abril de 2021.

Assinatura Eletrônica
JOÃO CARLOS DIAS MEDEIROS
Diretor Administrativo e Financeiro

Assinatura Eletrônica
DR. LUCIANO BATISTA LOPES
Diretor Técnico

Assinatura Eletrônica
LEONARDO DE O. TOLEDO SILVA
Diretor Geral





CI/HGP/NASST/ N° 122/2020.

De: NASST/HGP

Palmas - TO, 12 de abril de 2021.

Para: Coordenação de Almoxarifado - HGP

Assunto: Parecer Técnico – EPI (Equipamento de Proteção Individual)

EPI: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL
FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2

Classe: PFF-2 "S"

Fabricante: Alliance - Equipamentos de Proteção Individual

Considerando a NR 06 – Equipamento de Proteção Individual, item 6.2: O equipamento de proteção individual, de fabricação nacional ou importado, só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação - CA, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego.

Considerando que o respirador supracitado possui certificado de aprovação - CA N° 38.811 com validade até 21/05/2022, cujo CA foi emitido pelos órgãos competentes em matéria de saúde e segurança do trabalho, SIT – Secretaria de Inspeção do Trabalho, Ministério do Trabalho e Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho.

Considerando a **RESOLUÇÃO - RDC N° 379, DE 30 DE ABRIL DE 2020** Altera a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 356, de 23 de março de 2020, que dispõe, de forma extraordinária e temporária, sobre os requisitos para a fabricação, importação e aquisição de dispositivos médicos identificados como prioritários para uso em serviços de saúde, em virtude da emergência de saúde pública internacional relacionada ao SARS-CoV-2.

Considerando ainda a **RESOLUÇÃO - RDC N° 379, DE 30 DE ABRIL DE 2020:**

Art. 2º A fabricação, importação e aquisição de máscaras cirúrgicas, respiradores particulados N95, PFF2 ou equivalentes, óculos de proteção, protetores faciais (face shield), vestimentas hospitalares descartáveis (aventais/capotes impermeáveis e não impermeáveis), gorros e propés, válvulas, circuitos e conexões respiratórias para uso em serviços de saúde ficam excepcional e temporariamente dispensadas de Autorização de Funcionamento de Empresa, da notificação à Anvisa, bem como de outras autorizações sanitárias.





Art. 3º A dispensa de ato público de liberação dos produtos objeto deste regulamento não exige:

I - o fabricante e importador de cumprirem as demais exigências aplicáveis ao controle sanitário de dispositivos médicos, bem como normas técnicas aplicáveis; e

II - o fabricante e importador de realizarem controles pós-mercado, bem como de cumprirem regulamentação aplicável ao pós-mercado.

Art. 4º O fabricante ou importador é responsável por garantir a qualidade, a segurança e a eficácia dos produtos fabricados e importados em conformidade com esta Resolução.


Conclui-se que o referido EPI está em conformidade com os órgãos competentes em matéria de saúde e segurança no trabalho, logo pode ser comercializado e utilizado por profissionais em atividades que exigem proteção respiratória, respeitando as características do equipamento de proteção individual e orientações do fabricante.

Ressalvo que se tratando de um EPI para proteção respiratória é importante que o fabricante apresente o Laudo de Eficiência de Partículas, bem como o Laudo de Eficiência de Filtragem Viral, haja vista que são documentos que comprovam suas respectivas eficiências, assegurando dessa forma a saúde e segurança dos trabalhadores que fazem o uso desse tipo de proteção respiratória durante suas atividades laborais no ambiente hospitalar.

Observação: O documento que comprova a certificação do EPI está anexo a este parecer.

At.te;

Gilcellion P. Silva
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA 317456/D-TO
NASST-HGP

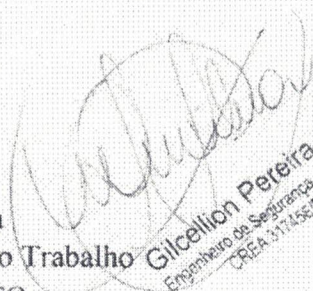
Gilcellion Pereira Silva
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA 317456/D-TO





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST



EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 39.235
VÁLIDO

Validade: 21/05/2022

Nº. do Processo: 12600.112326/2019-17

Produto: Nacional

Equipamento: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2

Descrição: Peça semifacial filtrante para partículas, formato dobrável, classe PFF2 "S". "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO".

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS (PFF2).

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO JUNTO AO INMETRO COM BASE NA PORTARIA INMETRO Nº 561, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014. II) Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Programa de Proteção Respiratória - recomendações, seleção e uso de respiradores", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho. III) Verifique a manutenção da certificação junto ao INMETRO no link: <http://www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/busca.asp>, utilizando como parâmetro de busca o CNPJ da empresa detentora do CA e a referência do EPI indicada no campo referência deste CA.

Marcação do CA: Na face interna.

Referências: ALLIANCE - PFF2

Cores: Azul externo e branco interno.

Normas técnicas: NBR 13697/2010, ABNT NBR 13698:2011

Laudos:

Nº. Laudo: Certificado de Conformidade nº 07345-03/2019

Laboratório: OCP: Instituto Falcão Bauer de Qualidade - IFBQ

Empresa: ALLIANCE SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 02.322.886/0001-15 CNAE: 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: GUANABARA 343

Bairro: JARDIM REPRESA - FAZENDINHA

Cidade: SANTANA DE PARNAIBA

CEP: 06529220

UF: SP



SGD: 2021/30559/053242

PARECER - 2/2021/SES/DRMATS/GRT

Palmas, 13/04/2021

ASSUNTO: Análise e parecer da Máscara PFF2 marca Alliance.**EMENTA:** Análise e Parecer da eficácia dos EPI's de proteção respiratória utilizados no enfrentamento da COVID-19 pelos trabalhadores das unidades hospitalares.**INTERESSADO:** Diretoria de Suprimentos Hospitalares

1- RELATÓRIO

Foi encaminhado a esta diretoria pedido de análise e parecer da máscara de proteção facial tipo respirador PFF2 "S" da **Fabricante Alliance** juntamente com amostra física, este item está em fase licitatória segundo processo nº2019/30550/006624, pregão eletrônico nº008/2020. Especificação em edital da máscara supracitada:


"Mascara de proteção facial tipo respirador, aplicação: proteção contra bacilo da tuberculose, constituído por fibras sintéticas dispostas em 4 camadas com formados em concha ou bico de pato; duas tiras elásticas para fixação na cabeça, clipe nasal fixado no corpo da mascara e eficiência mínima de filtração de 95% de partículas de até 0.3 micrometros; com certificado de aprovação como PFF/2 e da NIOSHI como N95 e registro do MS; descartável, atóxica, hipoalérgica e inodora."

2- FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA

A "portas de entrada" do vírus Sars Cov-2 no organismo é através das vias aéreas do sistema respiratório em forma de gotículas ou aerossóis. Para o bloqueio de aerossóis os órgãos de controle qualificam como eficiente os respirador faciais com classificação PFF2.

Segundo a literatura disponível em aerobiologia, aerossóis podem ser classificados em: sólidos ou líquidos/vivos ou mortos. O Sars Cov-2 é um bioaerossol, ou seja, um aerossol líquido/vivo contendo um núcleo viral, gerado através de secreções (saliva, catarro, muco etc.) formadas pelas vias respiratórias:





Muco - secreção composta de água, células, sais e mucina (glicoproteína);

Saliva - secreção produzida pelas glândulas salivares e bucais, seu principal componente é a água (99% de seu peso).

Catarro - é composto de 90 a 95% por água, de 2 a 4% por mucinas (parte gelatinosa) e de 1% por sais, lipídios, componentes inflamatórios (vírus, bactérias...), restos celulares e outros.

A ABNT NBR 13698:2011 é a norma brasileira que qualifica equipamento de proteção respiratória em PFF e cita como classificação:

“As PFF são ainda classificadas de acordo com a sua capacidade de reter partículas sólidas e líquidas à base de água (S, aprovadas no ensaio com aerossol de cloreto de sódio, conforme ensaios realizados de acordo com 7.6.1) ou sólidas e líquidas à base de óleo ou outro líquido diferente de água (SL, aprovadas nos ensaios com aerossol de cloreto de sódio e de óleo de parafina ou de dioctilftalato, conforme ensaios realizados de acordo com 7.6.1 e 7.6.2, respectivamente).”

A máscara em análise possui as seguintes especificações:

- classificação PFF2
- classificação “S” (líquidos à base de água)
- Aprovação compulsória pelo Inmetro
- Certificado de Aprovação: C.A. 39.235
- Não possui válvula

3- CONCLUSÃO

Em conclusão, tem-se que o respirador facial PFF 2 da marca Alliance atende aos requisitos da NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020 (Atualização 6: 25 de fevereiro de 2021), onde recomenda a classificação PFF-2 para aerossóis gerados em procedimentos médicos. Em relação à classificação “S” (para partículas líquidas à base de água) conclui-se que o meio de transporte do vírus é aquoso pelo vírus está presente em secreções respiratórias, sendo este meio, predominantemente composto por água conforme citado em fundamentação técnica. Segue anexo a este parecer o Certificado de Conformidade nº 07345-03/2019 do C.A. 39.235 e cópia da manutenção da certificação junto ao INMETRO. Estes documento garantem que este EPI passou por testes laboratoriais baseados nas Normas técnicas: NBR 13697/2010, ABNT NBR 13698:2011 que o qualifica como PFF 2 – S.

MÁRCIA ALVES MATOS
Engenheira de Segurança do Trabalho
CAU nº48782-1

TIAGO PEREIRA DA SILVA
Gerente de Regulação do Trabalho

ROBSON JOSÉ DA SILVA
Diretor de Regulação, Monitoramento e
Avaliação do Trabalho



Documento foi assinado digitalmente por ROBSON JOSE DA SILVA em 14/04/2021 15:20:57.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://sgd.to.gov.br/verificador>, informando o código verificador: 25462E0D00C3E191



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST



EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 39.235
VÁLIDO

Validade: 21/05/2022

Nº. do Processo: 12600.112326/2019-17

Produto: Nacional

Equipamento: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2

Descrição: Peça semifacial filtrante para partículas, formato dobrável, classe PFF2 "S". "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO".

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS (PFF2).

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO JUNTO AO INMETRO COM BASE NA PORTARIA INMETRO Nº 561, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014. II) Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Programa de Proteção Respiratória - recomendações, seleção e uso de respiradores", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho. III) Verifique a manutenção da certificação junto ao INMETRO no link: <http://www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/busca.asp>, utilizando como parâmetro de busca o CNPJ da empresa detentora do CA e a referência do EPI indicada no campo referência deste CA.

Marcação do CA: Na face interna.

Referências: ALLIANCE - PFF2

Cores: Azul externo e branco interno.

Normas técnicas: NBR 13697/2010, ABNT NBR 13698:2011

Laudos:

Nº. Laudo: Certificado de Conformidade nº 07345-03/2019

Laboratório: OCP: Instituto Falcão Bauer de Qualidade - IFBQ

Empresa: ALLIANCE SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 02.322.886/0001-15 CNAE: 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: GUANABARA 343

Bairro: JARDIM REPRESA - FAZENDINHA

Cidade: SANTANA DE PARNAIBA

CEP: 06529220

UF: SP

BRASIL



Site do Inmetro



SESAU
Proc: _____
Fls nº 1276
Visto

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:

1 Certificado(s)

1 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: IFBQ N° Certificado: 07345-03/2019 Tipo: Produto Emissão: 22/05/2019 Validade: 21/05/2022 Status do Certificado: Ativo Doc. Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
02322886000115	ALLIANCE SOLUÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP		RUA GUANABARA, 343 -- FAZENDINHA - SANTANA DO PARNAIBA, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
ALLIANCE	PFF2/AZUL EXTERNO E BRANCO INTERNO	NÃO	PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTICULAS, FORMATO DOBRÁVEL, CLASSE PFF2 *S*, INDICADO PARA POEIRAS, NEVOAS E FUMOS.

Novos Produtos

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados